

お客様各位

株式会社アグリス

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-6-6 MIF ビル 6階
TEL 03-3233-2077 FAX 03-3233-2079

メディカル営業統括管理部

「処置キット部材」仕様変更のお知らせ

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて このたび弊社処置キットの部材仕様を一部変更致しますのでご案内申し上げます。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更部材・内容

■変更部材名

- ①AG ガーゼ 2.5×5 24P
- ②AG ガーゼ 3.75×5 24P
- ③AG ガーゼ 3×3 50P
- ④AG ガーゼ 5×5 12P
- ⑤AG ガーゼ 5×7.5 12P
- ⑥AG ガーゼ 7.5×7.5 12P
- ⑦AG ガーゼ 7.5×7.5 16P

■変更内容

部材仕入先を変更致します。

これにより、従来と比べ以下の変更が発生致します。

詳細につきましては4項をご参照ください。

- ① 折り曲げ方に違いが発生します。
- ② 生地を全面広げた際、端面の折り返しがなくなります。

なお、本変更における生地材質に変更はございません。

2. 変更理由

品質向上と安定供給実現のため

3. 変更品出荷開始時期

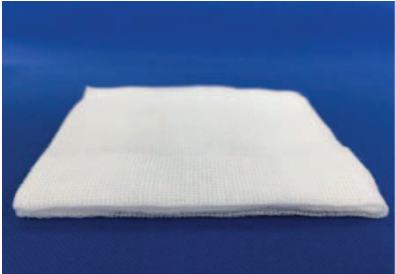
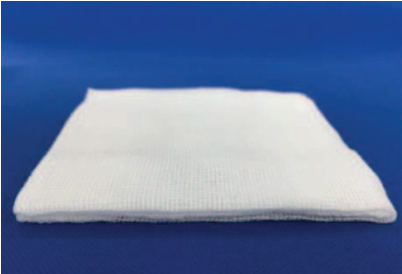
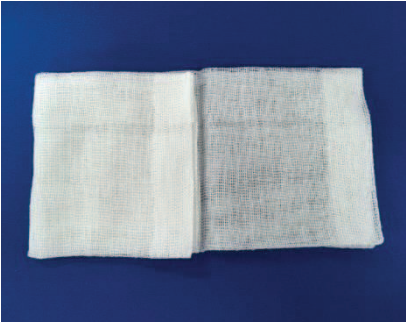
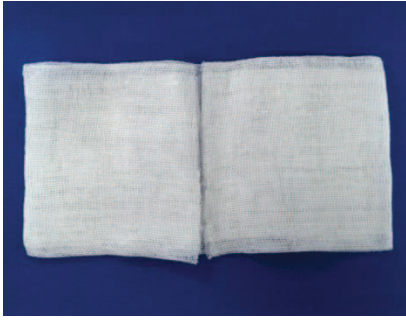

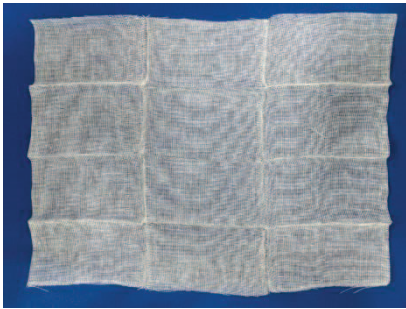
2021年8月製造分より随時変更

※在庫状況により出荷時期が前後する場合がありますので、何卒ご了承下さい。

4. 変更内容

ガーゼの折り曲げ方が変わります。なお、変更前後ともに「医療ガーゼ・医療脱脂綿基準」に適合しており、製品の有効性・安全性に問題ないことを確認済みです。

(変更箇所の例 写真は AG ガーゼ 7.5×7.5 12P)

状態	変更前	変更後
完成品外観		
展開写真		
生地写真 (全展開)	 <p data-bbox="635 1760 858 1794">端面折り返しあり</p>	 <p data-bbox="1114 1760 1337 1794">端面折り返しなし</p>

以上

ISOR-097 2019.05.01